




WIWA SYA 5B - LOOP

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar          | Up & Down; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 45,5 cm; Alto del espaldar: Min: 70,5 cm; Graduable en altura: 9,5 cm.                                                                                                 |
| Soporte lumbar    | Graduable en profundidad; 2,5 cm; Soporte lumbar tapizado en malla negra; Espuma laminada densidad 26 gr/dm³                                                                                                                                                                                    |
| Asiento           | Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm³; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale. |
| Mecanismo         | SYA 5B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Autopesante; Antishock.                                                                                                                                                                                      |
| Columna neumática | Presidente; Graduable en altura: 8 cm.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Base              | Loop; En aluminio inyectado; Diámetro: 70 cm.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodachinas        | Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.                                                                                                                                                                                                            |
| Capacidad de peso | En posición de trabajo hasta 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                            |


ACCESORIOS OPCIONALES:

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismo Slider | Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.                                                          |
| Brazos           | 1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano. |
| Cabecero         | Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.                                          |

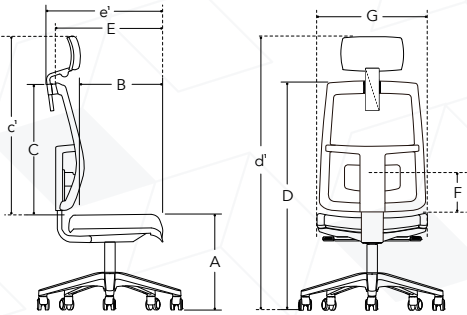


0,45 m³ 0,18 m³ 14,6 kg


| DIMENSIONES DE LA SILLA<br>GRADUACIONES |                                                         | SIN SLIDER |       | CON SLIDER |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                         |                                                         | Min        | Max   | Min        | Max   |
| A                                       | Altura del piso al plano superior del asiento.          | 41,3       | 49,3  | 43,3       | 51,3  |
| B                                       | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. | 39,5       | 42    | 39,5       | 46,5  |
| C                                       | Altura efectiva del espaldar.                           | 59         | 68,5  | 57         | 66,5  |
| C'                                      | Altura efectiva del espaldar con cabecero.              | 73,5       | 90    | 71,5       | 88    |
| D                                       | Altura total de la silla.                               | 97,6       | 115,1 | 97,6       | 115,1 |
| d'                                      | Altura total de la silla con cabecero.                  | 112,1      | 136,6 | 112,1      | 136,6 |
| E                                       | Profundidad total de la silla.                          | 52,5       | 52,5  | 52,5       | 57,5  |
| e'                                      | Profundidad total de la silla con cabecero.             | 54         | 54    | 54         | 59    |
| F                                       | Altura efectiva del soporte lumbar.                     | 19,5       | 29    | 17,5       | 27    |
| G                                       | Ancho total del asiento sin brazos.                     | 51,5       | 51,5  | 51,5       | 51,5  |

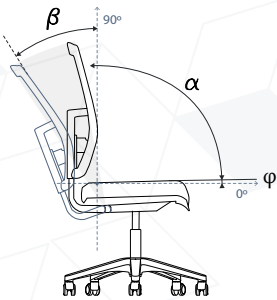



| ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR |                                                    |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                            | Min                                                | Max         |
| φ                          | Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. | 0° 4,5°     |
| α                          | Ángulo entre el asiento y el espaldar.             | 102° 115,5° |
| β                          | Ángulo entre la vertical y el espaldar.            | 12° 30°     |

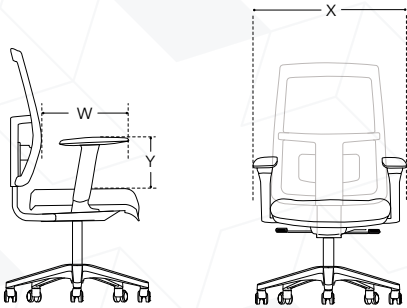


| DIMENSIONES Y AJUSTES<br>DE LOS BRAZOS |                                                             | BRAZOS 1D |     | BRAZOS 4D |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|------|
|                                        |                                                             | Min       | Max | Min       | Max  |
| Y                                      | Altura del brazo desde el plano del asiento.                | 21,5      | 28  | 23,5      | 30   |
| W                                      | Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad. | 32        | 32  | 29,7      | 34,2 |
| X                                      | Ancho total a la parte externa de los brazos.               | 68        | 68  | 67        | 69   |

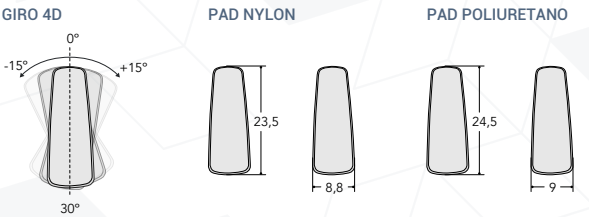

Colores de malla disponibles

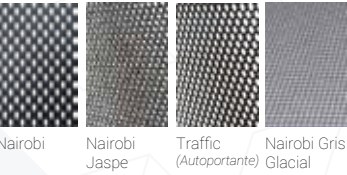

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.  
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.  
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.  
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.  
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.  
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.  
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado